

エピペン®注射液0.3mgをお持ちの患者様へ お詫びとお願いです

下記製品の一部に不具合の可能性があるため自主回収しております。
多大なご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

「製造番号:PS00019A 使用期限:2017.4」


「製造番号:PS00025A 使用期限:2017.10」と記載された

エピペン®注射液0.3mgが回収対象製品です。

エピペン®注射液0.3mgの外箱




箱側面に記載

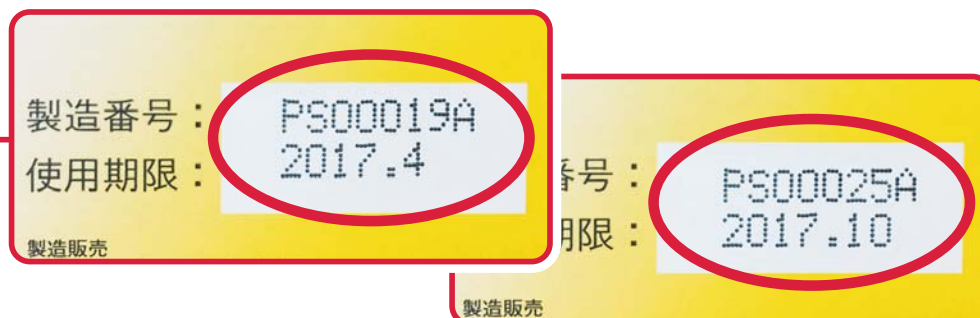

エピペン®注射液0.3mgの本体



ペン裏側に記載

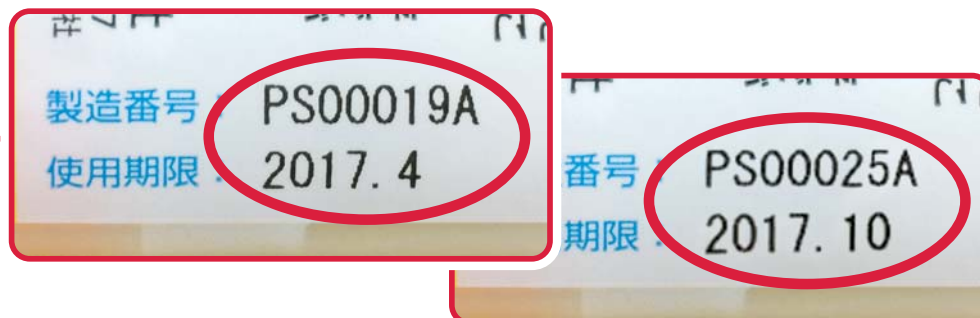

現在お持ちのエピペン®注射液の製造番号をご確認いただき、回収対象製品の場合は、
速やかに同製品を受け取った医療機関/薬局に製品交換をお申し出ください。

■ ご注意点

1. 携帯用の専用ケースに入れてお取り扱いください。(誤投与の危険性があります)

- 青色の安全キャップは絶対に外さないでください。
- オレンジ色のニードル(注射針)カバーの先端に指をかけないでください。

オレンジ色のニードルカバー 青色の安全キャップ



2. エピペンは薬液や注射針が含まれるため、家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご自宅で廃棄なさらず、同製品を受け取った医療機関/薬局までご連絡いただきますようお願いいたします。

本件に関するお問い合わせ窓口 ファイザー株式会社 エピペン回収特設窓口

 **0120-665-766**

受付時間：平日(月～金) 9:00～17:30